



















SOEHNLE



Analoge Personenwaage
Analogue Personal Scale

150 kg Traglast
150 kg load capacity

Extrahohle Vollschichtplatte
Extra-large full-view dial

Individuell justiert, getestet und geprüft
Individually aligned, tested and certified

Analoge Personenwaage
Analogue Personal Scale
www.soenhle.com


SOEHNLE









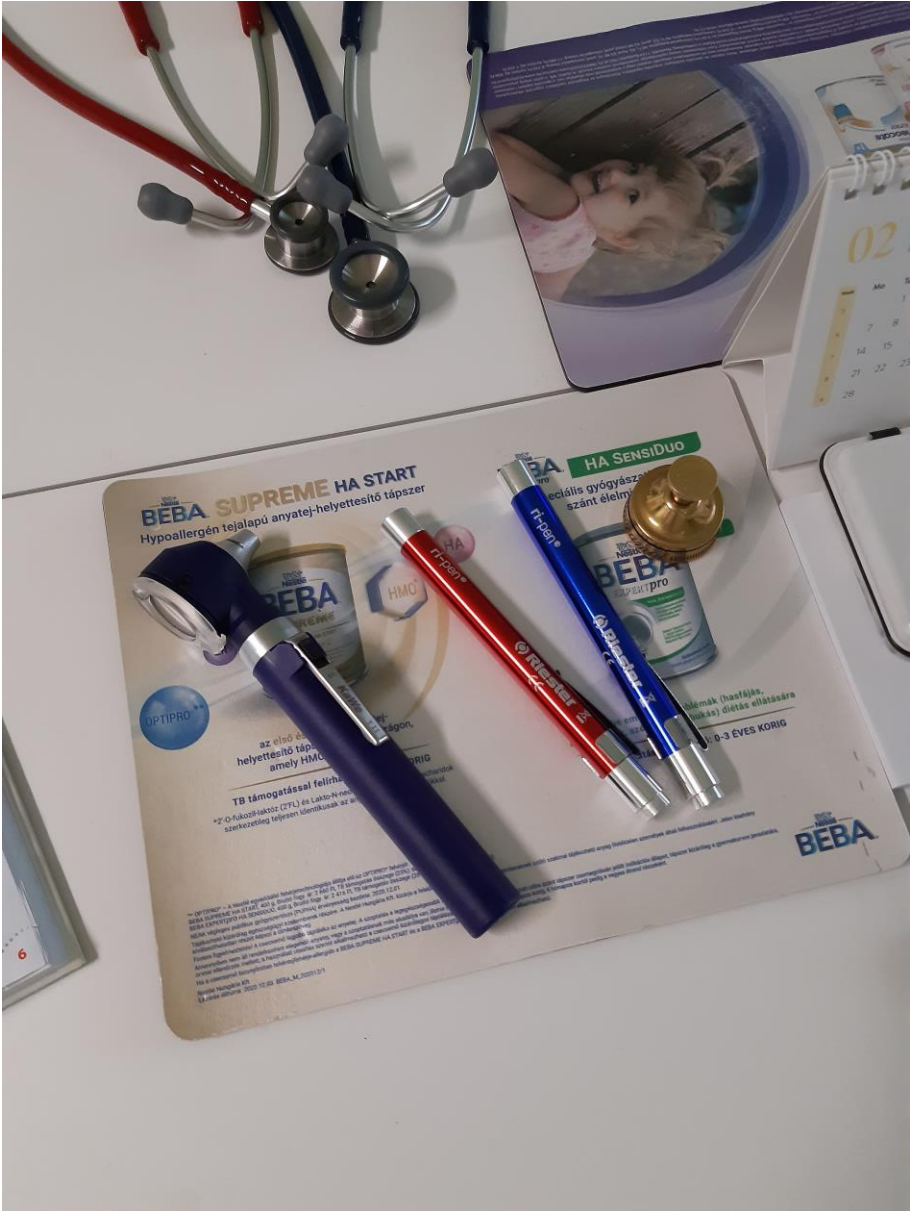









For Professional Use Only

- Instruments must be cleaned and sterilized prior to first use.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.
- Instruments must be lubricated after every cleaning, before autoclaving.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.



Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA

Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA



Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA

For Professional Use Only

- Instruments must be cleaned and sterilized prior to first use.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.
- Instruments must be lubricated after every cleaning, before autoclaving.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.

Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA



For Professional Use Only

- Instruments must be cleaned and sterilized prior to first use.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.
- Instruments must be lubricated after every cleaning, before autoclaving.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.



Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA

Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA



Distribuido por:
Henry Schein Inc.
Miami, FL 33137 USA

For Professional Use Only

- Instruments must be cleaned and sterilized prior to first use.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.
- Instruments must be lubricated after every cleaning, before autoclaving.
- Ratchet type instruments must never be locked during autoclaving.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.

Unicamente Para Uso Profesional

- Los instrumentos deben ser limpiados y esterilizados antes del primer uso.
- Los instrumentos deben ser lubricados después de cada limpieza.
- Los instrumentos con sistema de cierre no deben estar bloqueados durante el proceso de esterilización.

Pour Usage Professionnel Uniquement

- Les instruments doivent être lubrifiés avant de les utiliser pour la première fois.
- Les instruments doivent être lubrifiés après les avoir nettoyés, mais avant de les stériliser à l'autoclave.

Nur Zum Gebrauch in der Zahnmedizin

- Vor der ersten Benutzung müssen die Instrumente gereinigt und sterilisiert werden.
- Nach jeder Reinigung müssen die Instrumente vor dem Autoklavieren geölt werden.





Rien Air
Medical Technologies

SWISS
TECHNOLOGY

MADE IN SWITZERLAND











